

Microsoft Defender SmartScreen によりメッセージが表示される場合


「C&C 医療教育統合システム」のインストール用プログラムをダウンロードする際に、「Microsoft Defender SmartScreen」により下記メッセージ（図 1）が表示される場合には、下記手順でインストールを行ってください。

※下記は Microsoft Edge での操作方法になります。


（図 1）



手順 1：メッセージにマウスのカーソルを合わせて、下記○部分をクリックしてください。

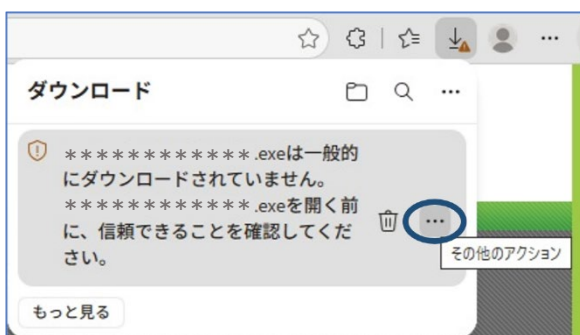

手順 2：下図にて保存をクリックしてください。

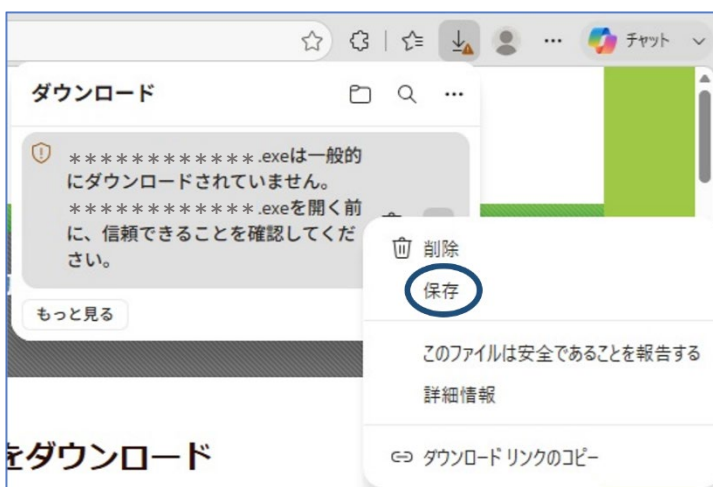


手順 3 : 下図にて○部分をクリックして、〔保持する〕をクリックしてください。



手順 4 : 下図にて○部分をクリックすると、インストーラーが起動します。


以降の操作は、ウェブサイトのインストール方法と同様になります。

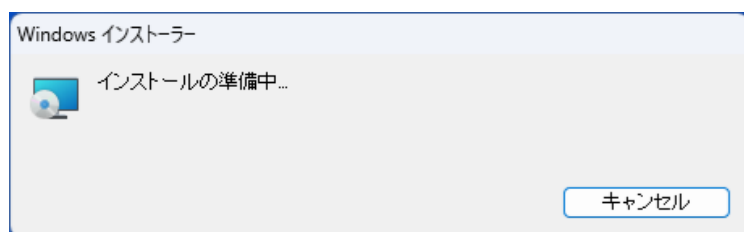

《参考》：Google Chrome の場合



ダウンロード後、ファイルを実行する際に、下記メッセージが表示される場合には、下記手順でインストールを行ってください。

手順 1：下記○部分をクリックしてください。

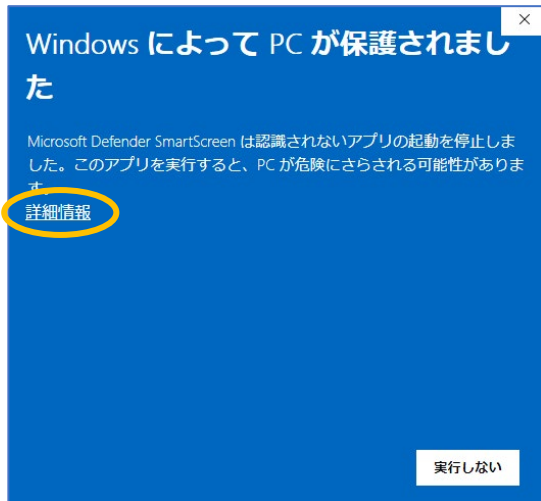

手順 2：〔実行〕をクリックしてください。

以降の操作は、ウェブサイトのインストール方法と同様になります。

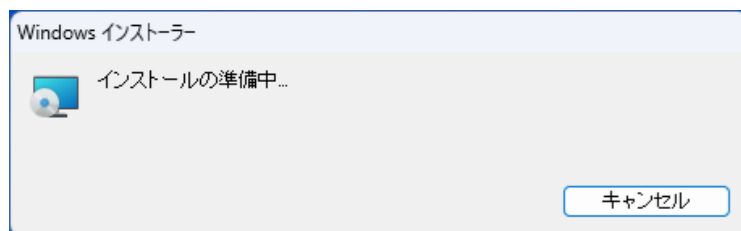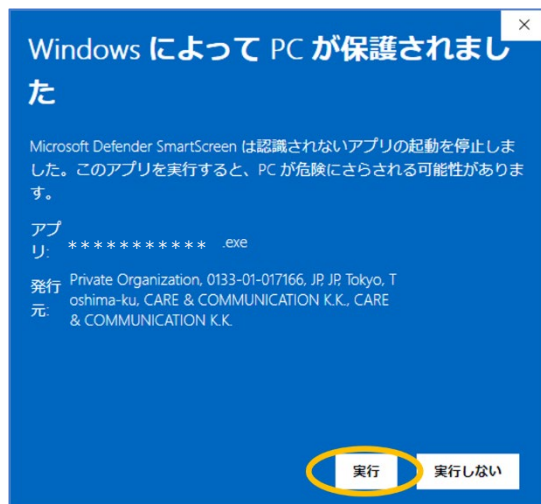

以上